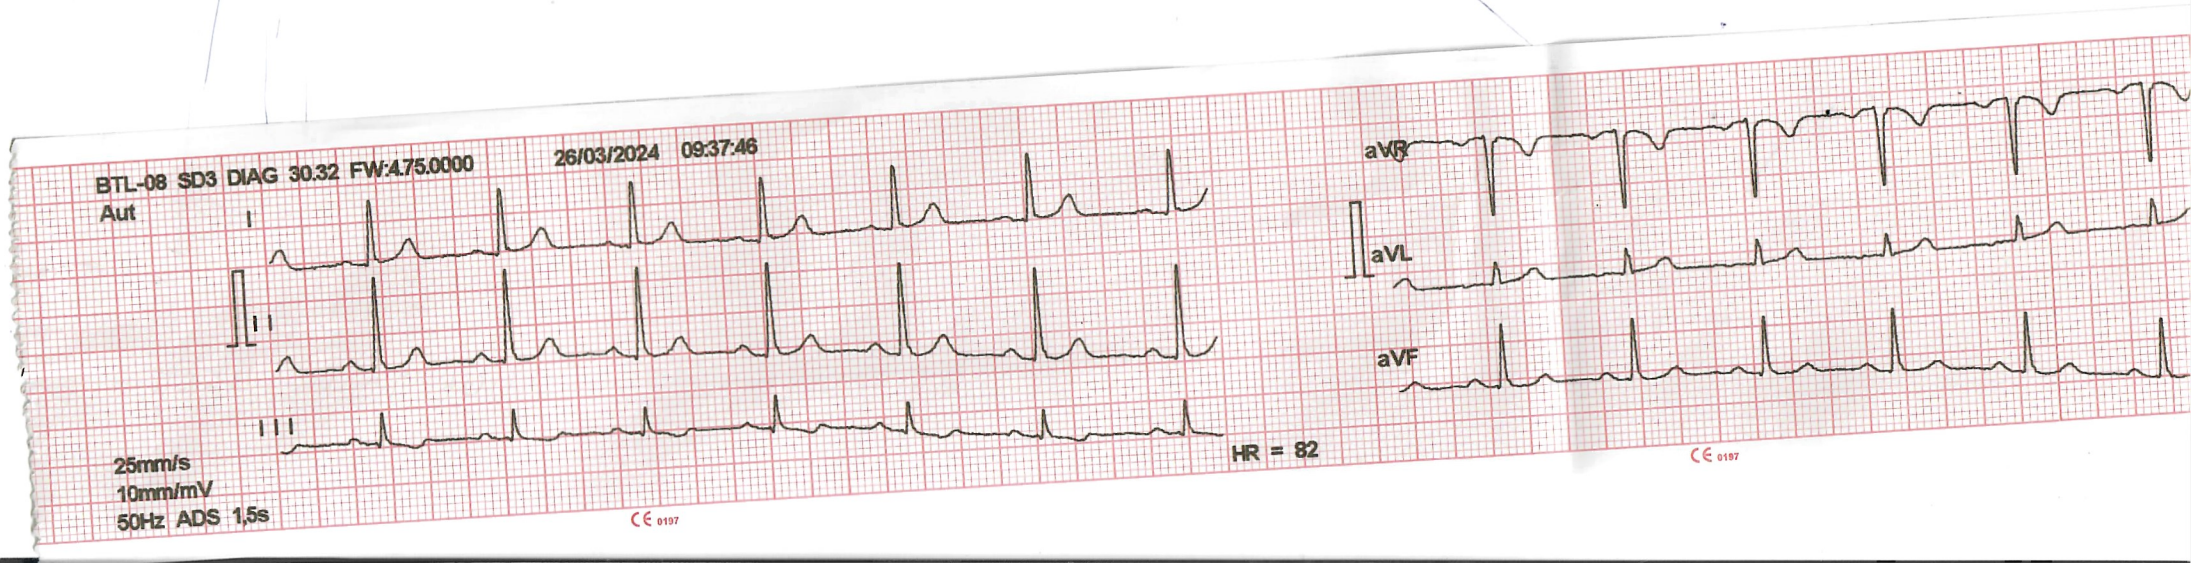
BTL-08 SD3 DIAG 30.32 FW:4.75.0000
26/03/2024 09:37:46
Aut
I
II
III
aVR
aVL
aVF
HR = 82
25mm/s
10mm/mV
50Hz ADS 1,5s
CE 0197
CE 0197


V1
V2
V3
V4
V5
V6
HR = 82
HR = 82
CE 0197
CE 0197

[uV]	P+	P-	Q	R	S	R'	S'	T+	T-	ST	STs [uV/s]
I	50	-	-	847	-	-	-	287	-	27	624
II	121	-	-55	1270	-	-	-	254	-	12	390
III	71	-	-	412	-	-	-	27	-69	-7	-266
aVR	-	-82	-	39	-1047	-	-	-	-265	-19	-498
aVL	-	-	-	276	-	-	-	168	-	13	459
aVF	96	-	-	848	-	-	-	117	-	3	68
V1	-	-	-	178	-1044	-	-	-	-107	19	-48
V2	63	-	-	477	-517	-	-	565	-	79	2083
V3	76	-	-	795	-	-	-	180	-	11	423
V4	70	-	-50	1471	-	-	-	282	-	6	442
V5	68	-	-69	1419	-	-	-	273	-	3	407
V6	63	-	-70	1185	-	-	-	218	-	0	251

SF	85 1/min
RR	702 ms
P	86 ms
QRS	94 ms
PQ	146 ms
QT	318 ms
QTc	379 ms
axis P	60 °
axis QRS	40 °
axis T	16 °

Dr Patrick CORREA
Médecine Aéronautique
SNA-MED 004
FFAA 00772

ECG DANS DES LIMITES NORMALES
RYTHME SINUSAL

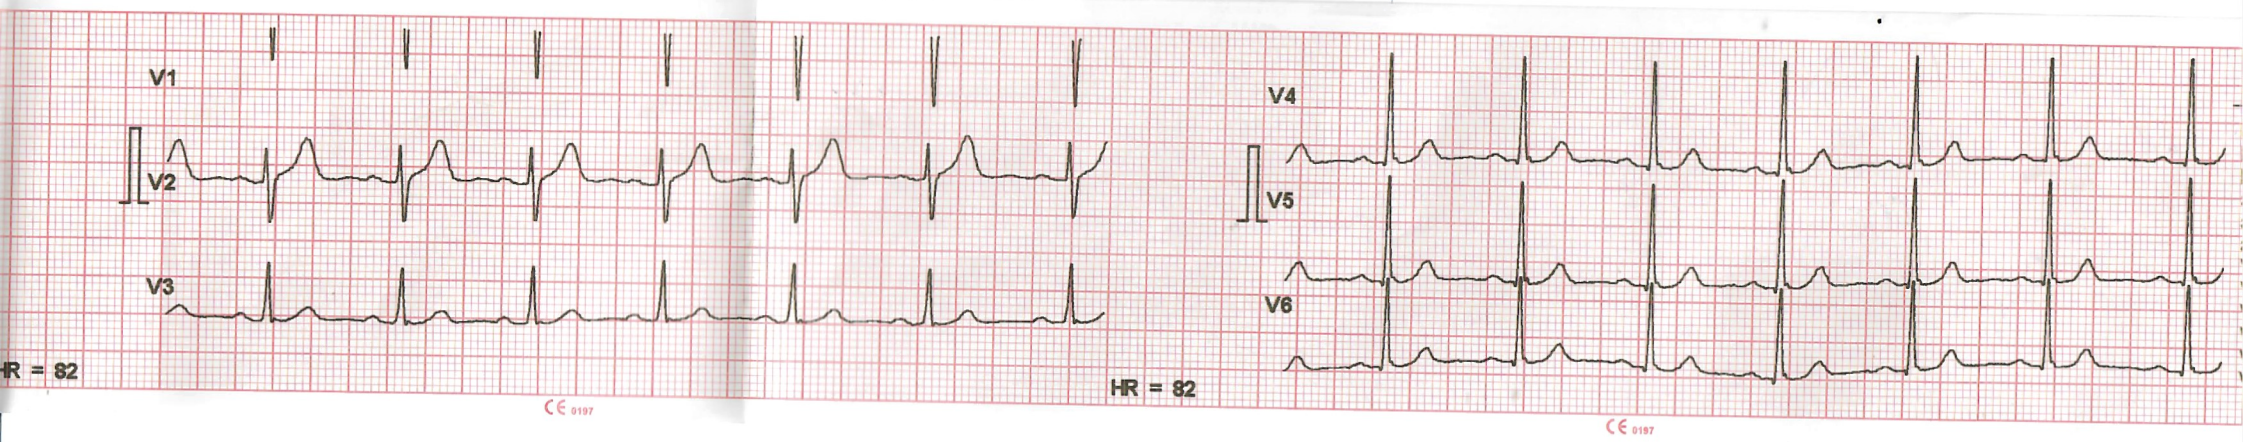Rokhyatou Badji

CE 0197