

Audiométrie tonale




Opérateur : Pauline Cansot

Patient **Francis Nardy**


Date de naissance 19 juin 1969

Date de mesure 18/10/2022 10:15:46

Droite

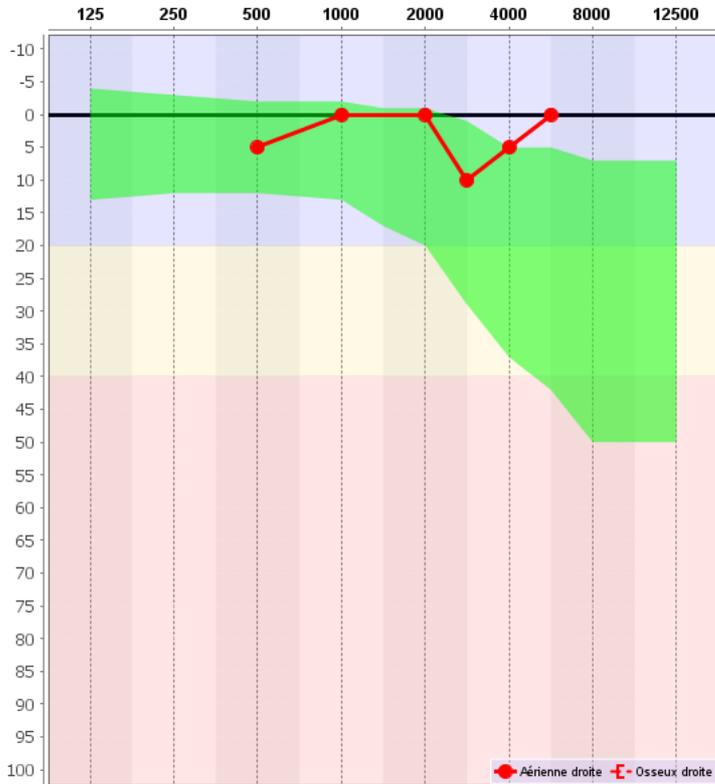

Gauche

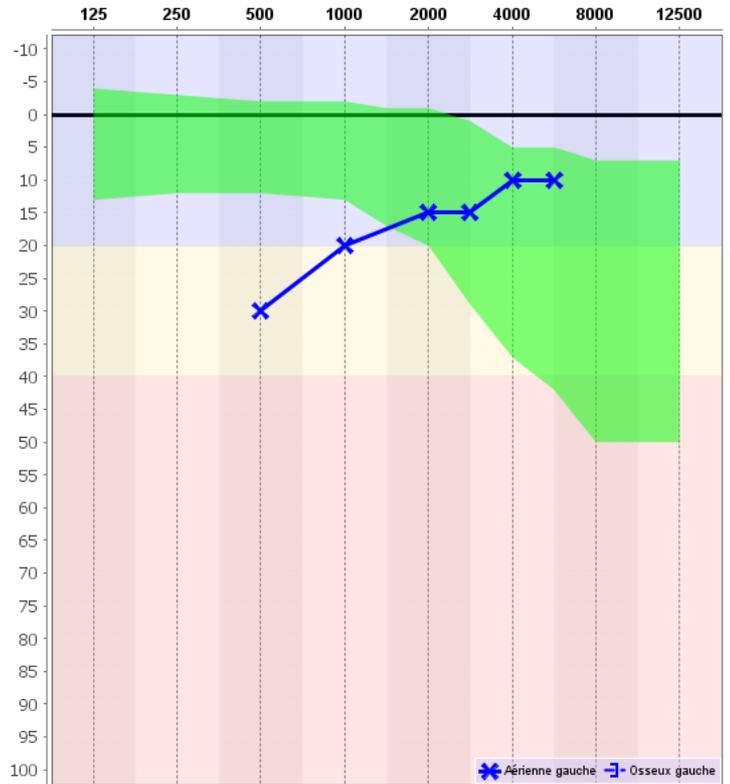

Indice Tonal Moyen	Gauche	Droite
Indice Tonal Moyen	21,67 dB HL	1,67 dB HL
Indice précoce d'alerte	11,67 dB HL	5,00 dB HL
Indicateur médico-légal	19,50 dB HL	1,50 dB HL
Indicateur de surdité professionnelle	18,75 dB HL	2,50 dB HL
Sigycop (O= 4)	Coef. : 4	Coef. : 1

Notes

Appareil utilisé pour la mesure
 Appareil : OtoWin
 S/N : 16088 - 038
 Firmware : 1.1.3d
 Hardware : rev9
 Stimulateur : DD45 HI
 Date de calibration : 26/07/2022