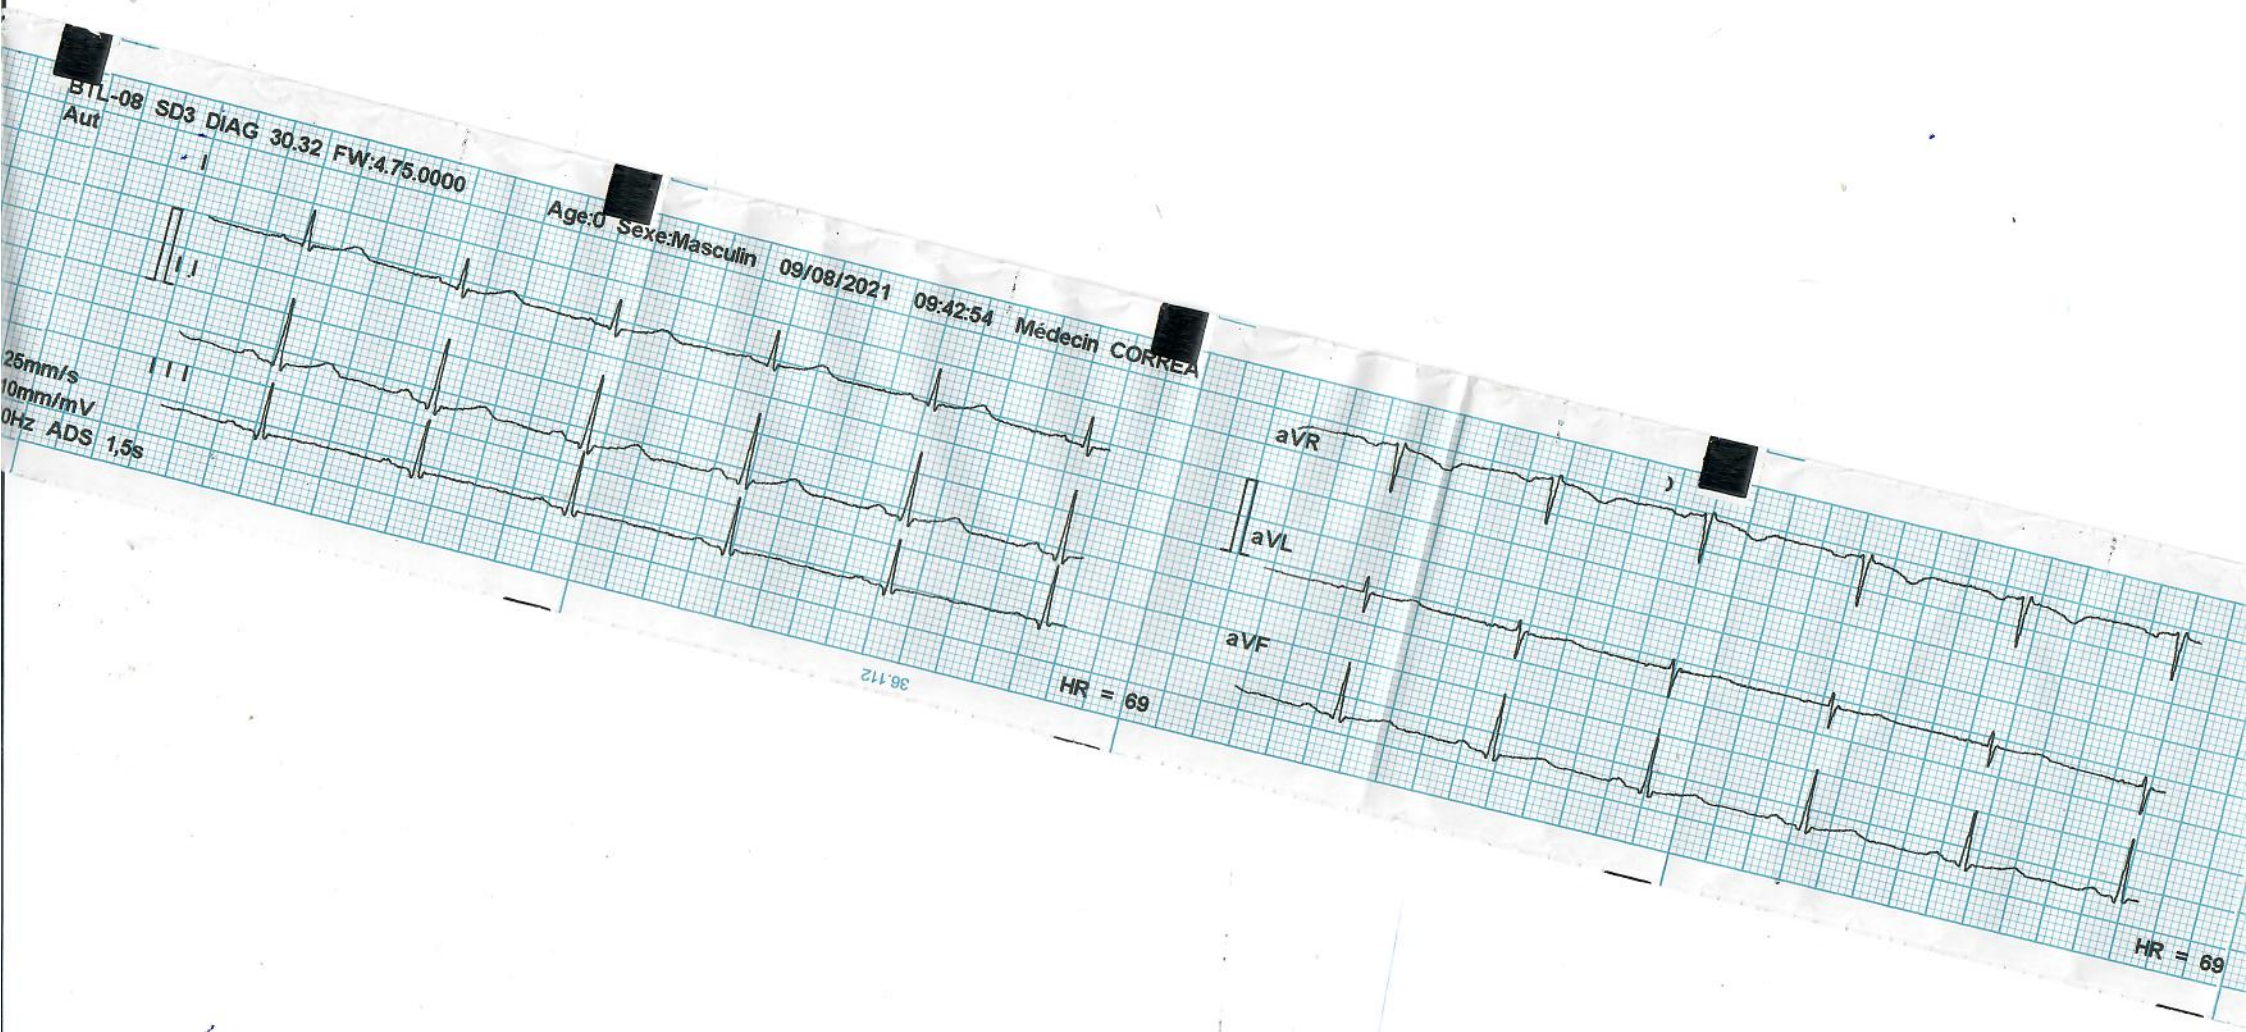
BTL-08 SD3 DIAG 30.32 FW:4.75.0000
Aut
Age:0 Sexe:Masculin 09/08/2021 09:42:54 Médecin CORREA
25mm/s
10mm/mV
0Hz ADS 1,5s
I
II
III
aVR
aVL
aVF
HR = 69
HR = 69

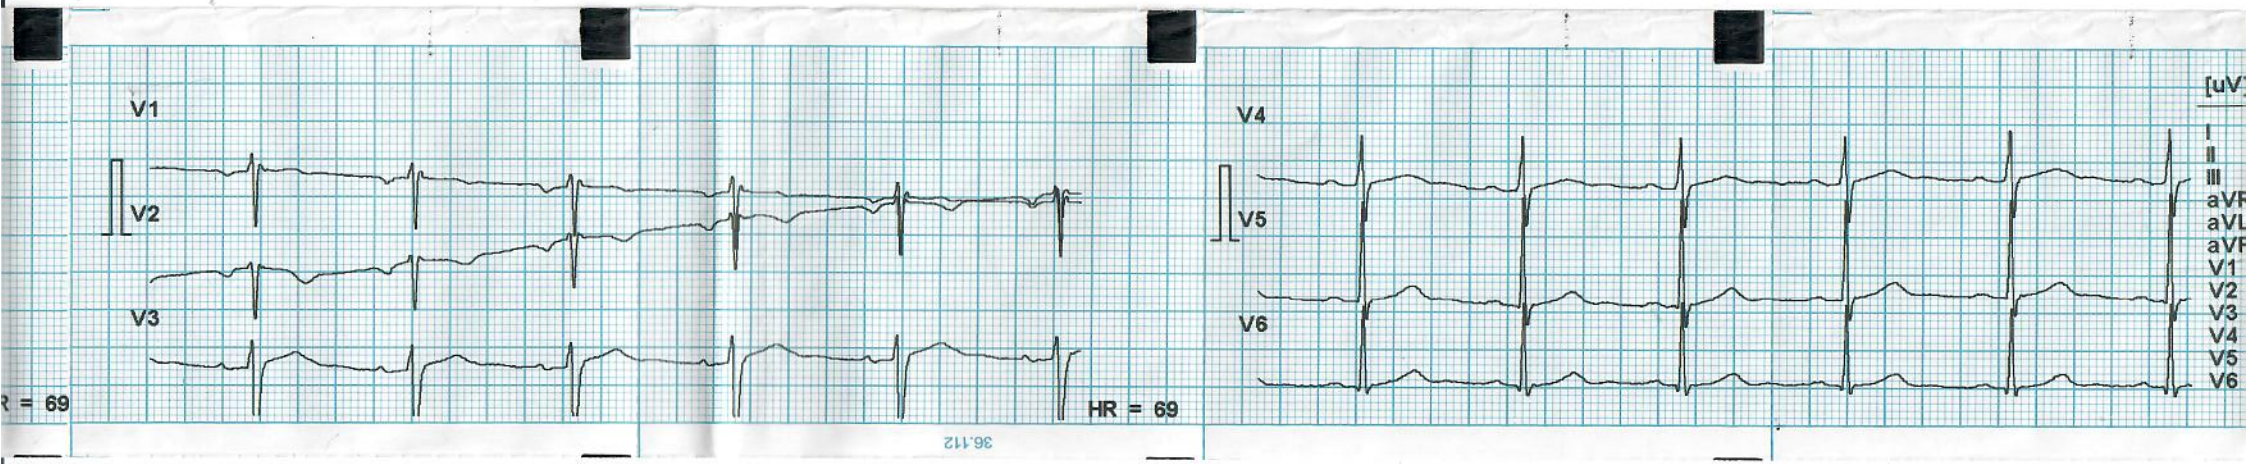
V1
V2
V3
V4
V5
V6
HR = 69
R = 69
[uV]
I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6