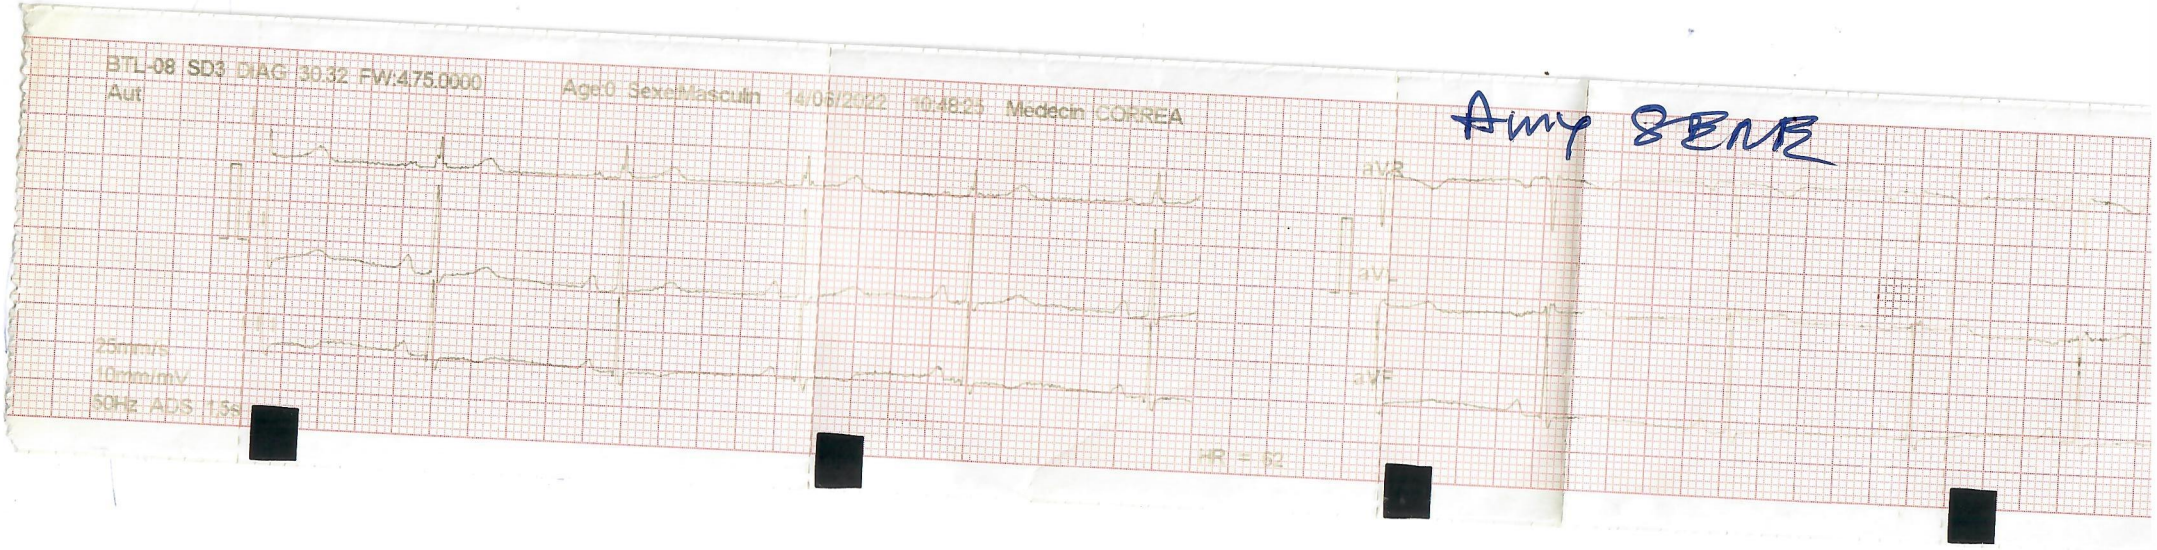
BTL-08 SD3 DIAG 30.32 FW:4.75.0000
Aut
Age:0 Sexe:Masculin 14/06/2022 10:48:25 Medecin CORREA
aVR
aVL
aVF
25mm/s
10mm/mV
50Hz ADS 1.5s
HR = 62

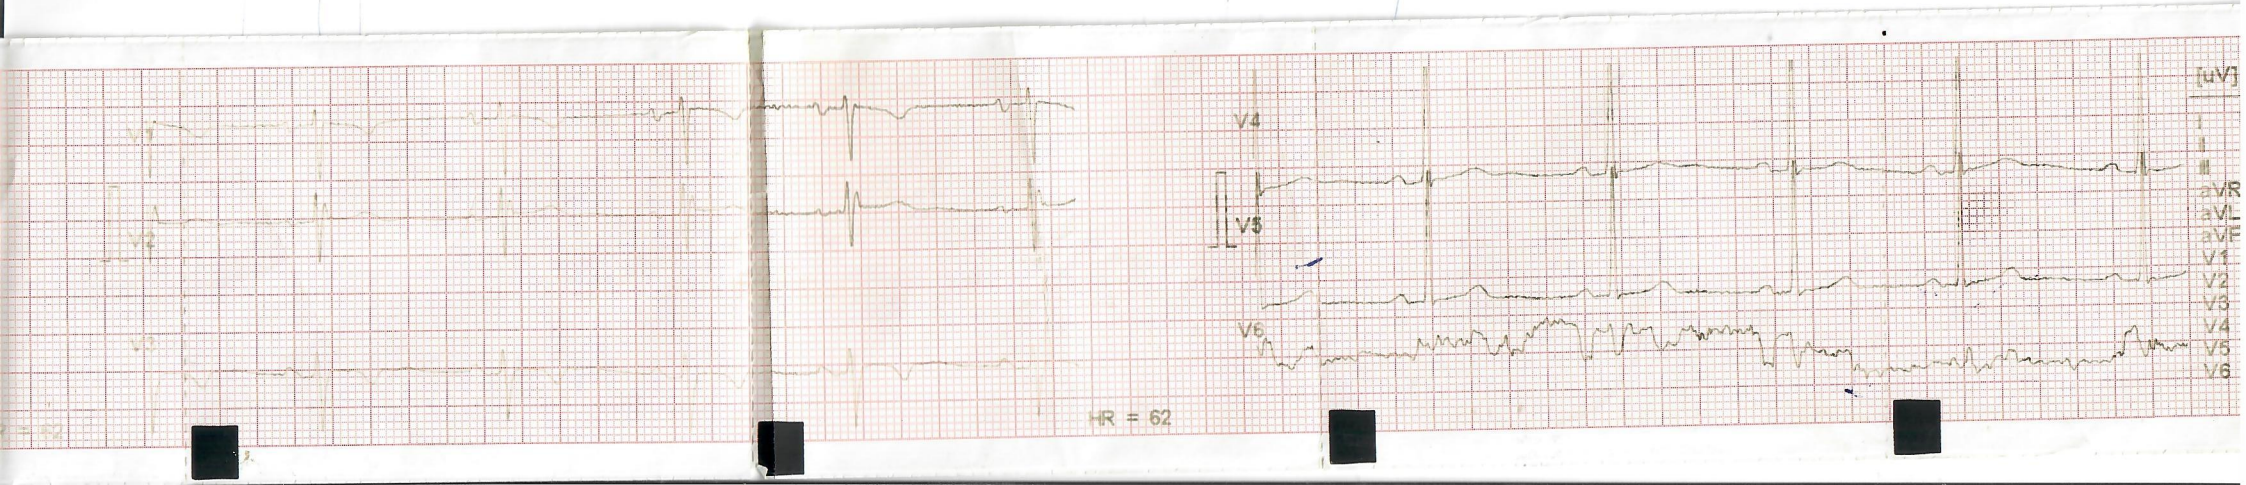
V4
V5
V6
HR = 62
[uV]
I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6

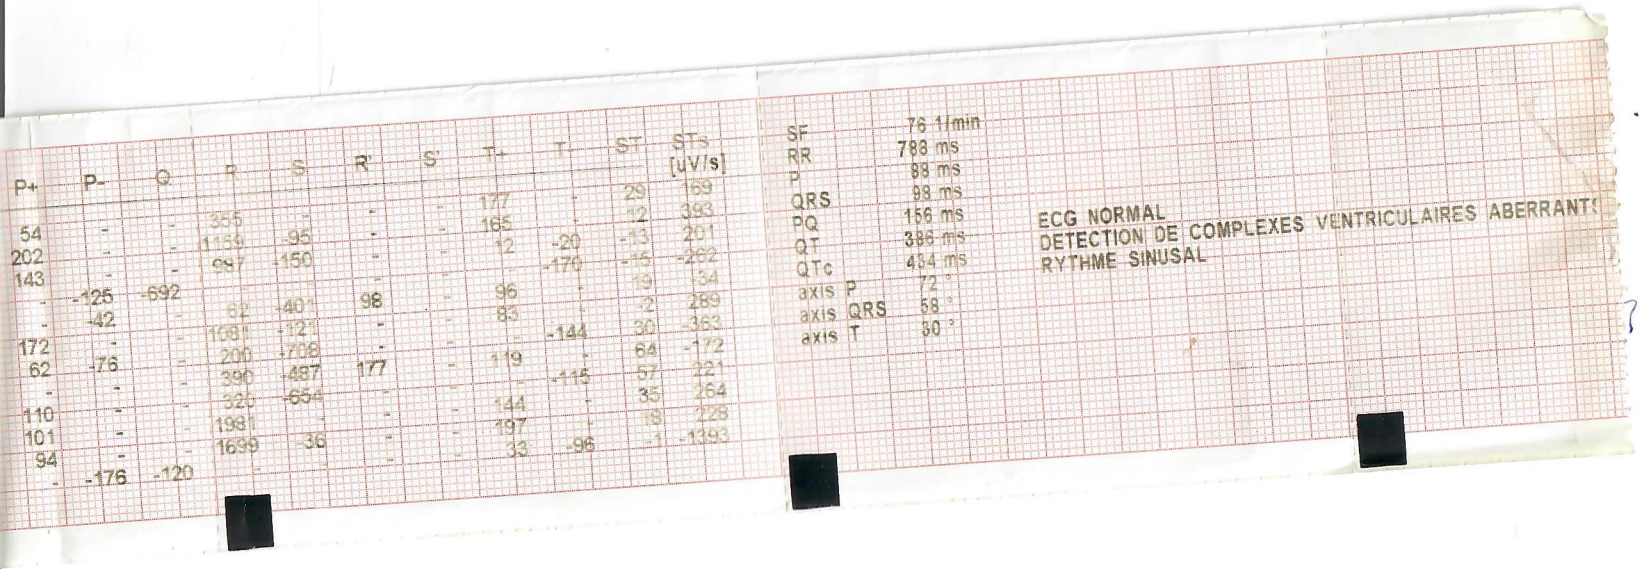
P+ P- Q R S R' S' T+ T- ST STs [uV/s]
54 - - - 355 - - - 177 - 29 169
202 - - - 1159 -95 - - 165 - 12 393
143 - - - 987 -150 - - 12 -20 -13 201
- -125 -692 - - - - - - -170 -15 -262
- -42 - - 62 -401 98 - 96 - 19 34
172 - - - 1081 +121 - - 83 - 2 289
62 -76 - - 200 +709 - - - -144 30 -363
- - - - 390 +487 177 - 119 - 64 -172
110 - - - 325 -654 - - - -115 57 221
101 - - - 198 - - - 144 - 35 264
94 - - - 1699 -36 - - 197 - 18 228
- -176 -120 - - - - - 33 -96 -1 -1393
SF 76 1/min
RR 788 ms
P 88 ms
QRS 98 ms
PQ 156 ms
QT 386 ms
QTc 434 ms
axis P 72 °
axis QRS 58 °
axis T 30 °
ECG NORMAL
DETECTION DE COMPLEXES VENTRICULAIRES ABERRANTS
RYTHME SINUSAL