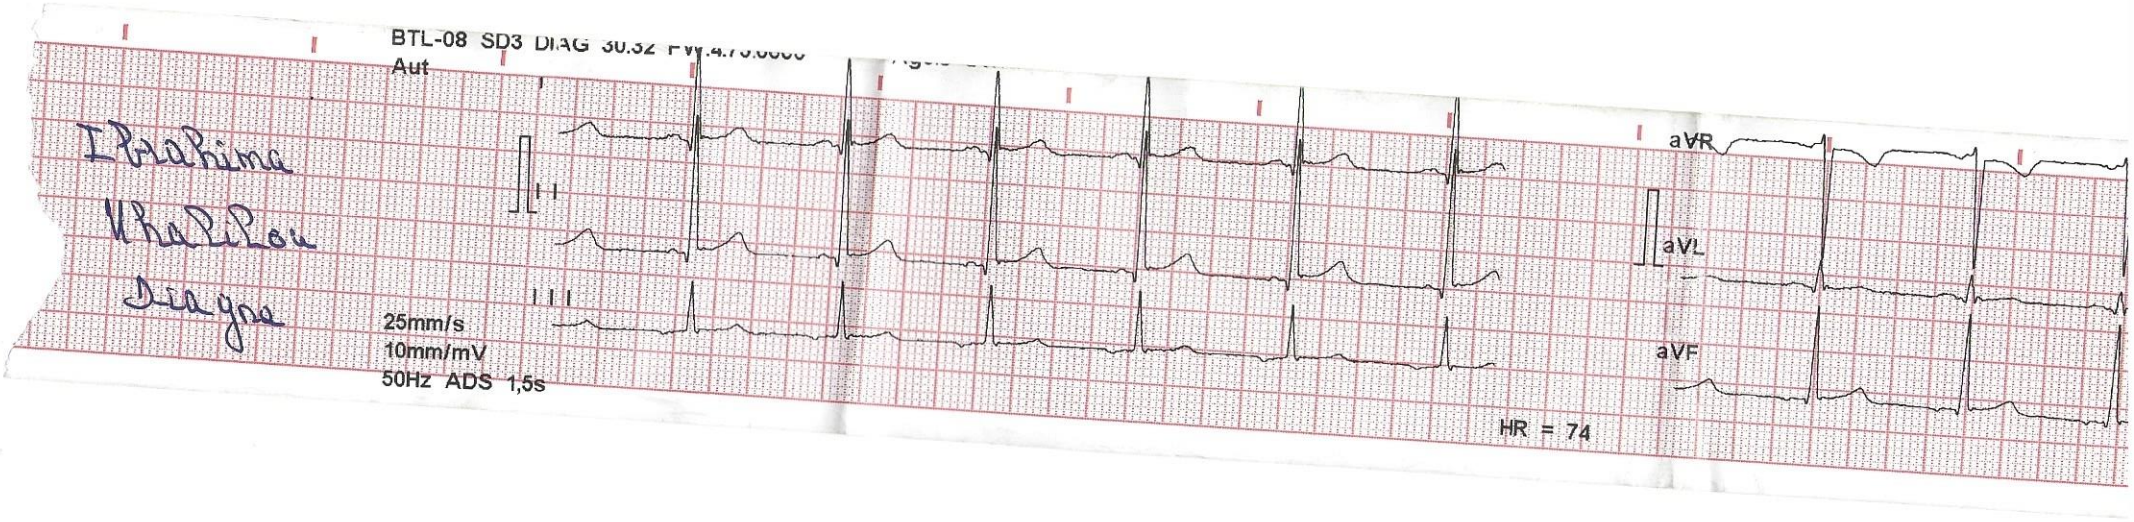
BTL-08 SD3 DIAG
Aut
I
II
III
aVR
aVL
aVF
25mm/s
10mm/mV
50Hz ADS 1,5s
HR = 74

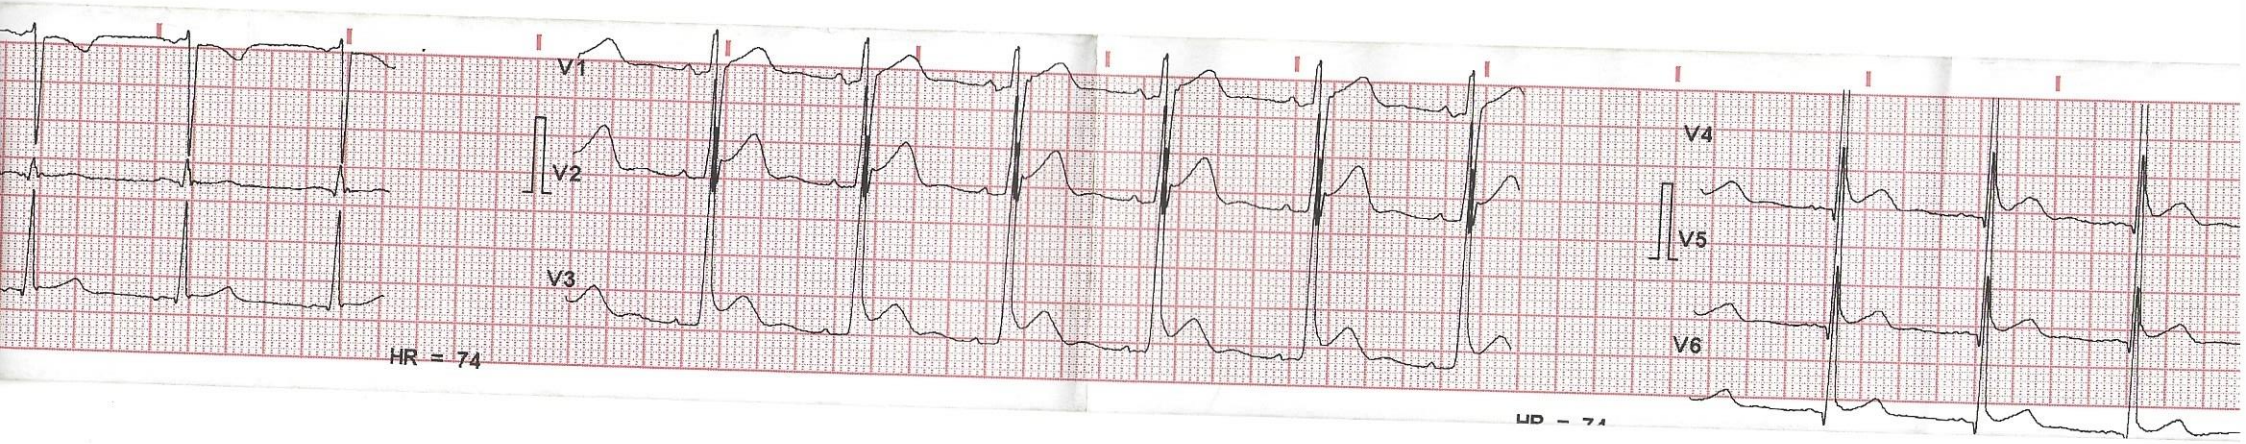
V1
V2
V3
V4
V5
V6
HR = 74

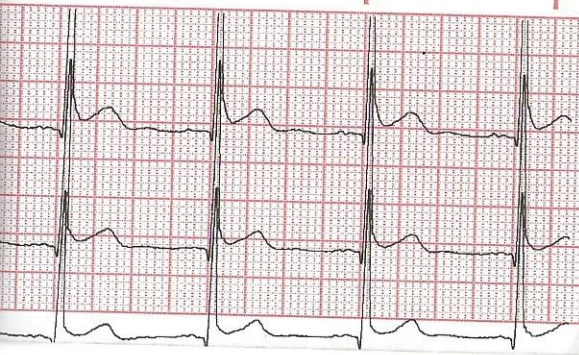

| [uV] | P+ | P- | Q | R | S | R' | S' | T+ | T- | ST | STs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | [uV/s] |
| I | 51 | - | -131 | 1156 | - | - | - | 192 | - | 43 | 644 |
| II | - | - | -136 | 1864 | - | - | - | 287 | - | 80 | 671 |
| III | - | -41 | - | 724 | - | - | - | 105 | - | 41 | 11 |
| aVR | - | -42 | - | 134 | -1491 | - | - | - | -240 | -61 | -646 |
| aVL | - | - | -56 | 272 | - | - | - | 54 | - | 1 | 283 |
| aVF | - | - | -60 | 1297 | - | - | - | 194 | - | 60 | 350 |
| V1 | 93 | - | - | 598 | -1522 | - | - | 384 | - | 135 | 1405 |
| V2 | 78 | - | - | 1324 | - | - | - | 640 | - | 245 | 2502 |
| V3 | 59 | - | - | 2667 | - | - | - | 480 | - | 288 | 1663 |
| V4 | - | - | -138 | 3280 | - | - | - | 328 | - | 189 | 1048 |
| V5 | - | - | -161 | 2439 | - | - | - | 262 | - | 113 | 675 |
| V6 | - | - | -162 | 1935 | - | - | - | 234 | - | 80 | 489 |

| | |
|---|---|
| SF | 76 1/min |
| RR | 794 ms |
| P | 106 ms |
| QRS | 122 ms |
| PQ | 118 ms |
| QT | 366 ms |
| QTc | 410 ms |
| axis P | -9 ° |
| axis QRS | 47 ° |
| axis T | 46 ° |

DEFAUT DE CONDUCTION INTRAVENTRICULAIRE IMPRECI
POSSIBILITE D'HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE GAUCHE
ELEVATION ST, INFARCTUS ANTERIEUR RECENT
ECG ANORMAL
RYTHME SINUSAL