


Fréquence en hertz (Hz)

Niveau d'audition en décibels (dB)

Fréquence (Hz)	Niveau d'audition (dB)
125	20
250	10
500	10
1K	15
2K	15
4K	15
8K	10

Date d'évaluation: 08/10/2020

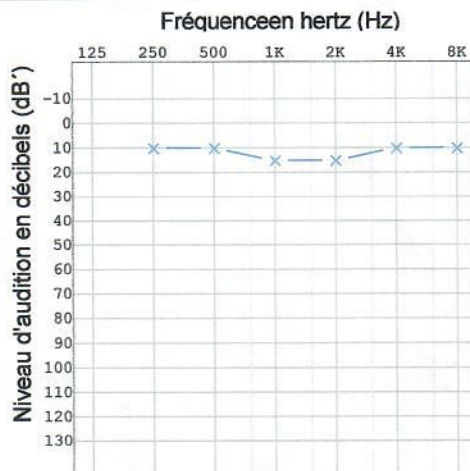


Légende			
	D	Binaural	G
CA	○		×
Non masqué			
CA	△		□
Masqué			
CO	<	^	>
Non masqué			
CO	[		]
Masqué			
MCL	M	M	M
UCL	m	m	m
SA	∅	S	×
Sans aide			
SAapp1	A ₁	A ₁	A ₁
Appareillé			

		Niveau de masage effectif										
Non-test Oreille		125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
CA	G											
	D											
CO	G											
	D											

Parole Notes	
Marque/modèle	
Date de calibrage	
Fiabilité du test	
Commentaires	
User Defined 1	
User Defined 2	

LABORATOIRE D'AUDITION
Jihane HOUDROUGE, AUDIOPROTHÈSE
CLINIQUE BELLEVUE, CAP
Tél: 77442 42 47- 33842 79 19

Ton pur Notes	
Marque/modèle	
Date de calibrage	
Méthode de test	
Fiabilité du test	
Commentaires	
User Defined 1	
User Defined 2	

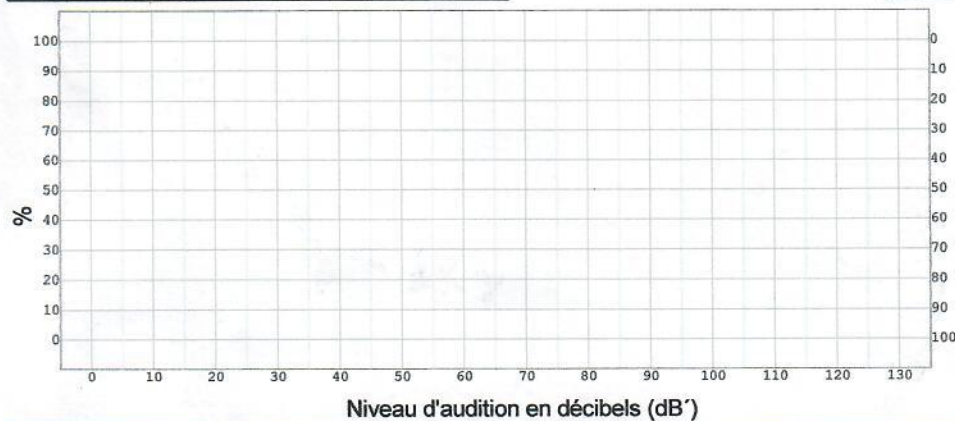

Légende		
D	Binaural	G

Oscopie normale
Pas de trouble

Signature: _____

Date: _____