

RESULTATS D'ANALYSES

Date de prélèvement : 10/07/2025

Prénom et Nom du patient : DIEMBE DIA


Téléphone :

Numéro d'ordre : 1123

Age : 46 ans sexe : M

Diagnostic : Visite médicale :

Paramètres	Résultats	Normes
Numération de formule sanguine	Voir annexe	
PSA	Voir annexe	<3,50 <7,6 ng/ml
GGT	49,7	<43 U/L

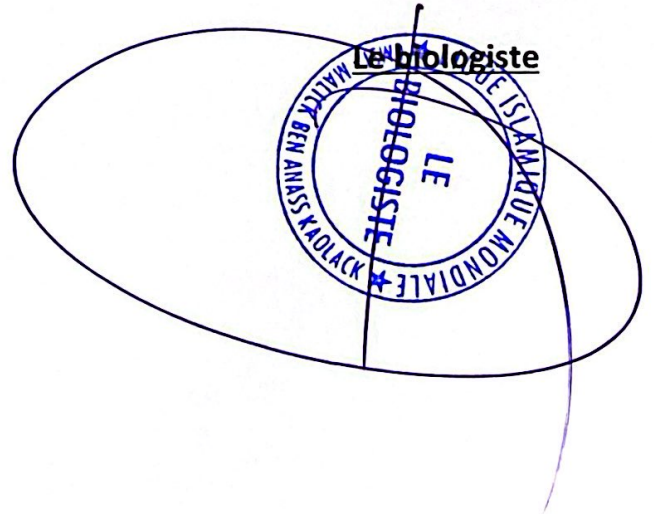

Email : cmsimalickbenanasskl@gmail.com Tel : 33-941-38-64 مستوصف مالك بن انس كولاخ



Prélèvement à domicile
Sur rendez - vous 7 jours/ 7

Ancien interne des Hôpitaux de Dakar – DES Biologie Clinique
DU Cytologie Hématologique – CU Tests Génétiques en Pathologie Médicale
DU Médecine et Biologie de la Reproduction

Immuno-Hématologie – Bactériologie
Virologie – Biochimie – Spermiologie
Parasitologie – Mycologie

Ancienne interne des Hôpitaux de Dakar
DES Biologie Clinique



Prélèvement du :11/07/2025 20:32:19



Compte Rendu d'Analyses Médicales

EXT

Marqueurs tumoraux

Examens demandés	Résultats	Unité	Normes	Antériorité
PSA total (Prostate-Specific Antigen) (CLIA, SNIBE)	0.76	ng/mL	< 40 ans : ≤ 1.4 40-49 ans: ≤ 2.0 ; 50-59 ans: ≤3,1 ; 60-69 ans: ≤4,1 ; ≥ 70 ans : ≤4,4	

Laboratoire BIO-AN-WA du RAI
Dr Ahmadou BOYE
~~Grand Pôtre, Pape de la Mission~~
Mbour Thies - Sénégal
Tel. 33 951 00 00 00 430 84 48

Adresse: Thiès, au rond-point parcelles, à 150m de la boulangerie - SÉNÉGAL

Téléphones: (221) 339510919 - 764308448 - 777524948 | **Email:** ahmadouboye@yahoo.fr

ID : 1123

Mode : Total

Heure : 10-07-2025 12:39

Nom : DIEUM DIA


Sexe : Mascul. Age : 46 ans

Fiche N° : 1123

Lit N° :

Serv. : externe

Paramètre		Résultat	Plage de réf.
GB		4.2 x 10 ⁹ /L	4.0 - 10.0
Lymph.		1.7 x 10 ⁹ /L	0.8 - 4.0
Mid.		0.5 x 10 ⁹ /L	0.1 - 0.9
Gran.		2.0 x 10 ⁹ /L	2.0 - 7.0
%lymph	H	40.4 %	20.0 - 40.0
% mid.	H	11.0 %	3.0 - 9.0
%gran	L	48.6 %	50.0 - 70.0
HGB		14.5 g/dL	12.0 - 16.0
GR		4.58 x 10 ¹² /L	4.00 - 5.50
HCT		40.1 %	40.0 - 50.0
VGM		87.7 fL	82.0 - 95.0
TMH	H	31.6 pg	27.0 - 31.0
CCMH	H	36.1 g/dL	32.0 - 36.0
IDR-LV		14.3 %	11.5 - 14.5
IDR-DS		45.3 fL	35.0 - 56.0
PLT		254 x 10 ⁹ /L	100 - 300
VMP		7.2 fL	7.0 - 11.0
IDP		15.5	15.0 - 17.0
PCT		0.182 %	0.103 - 0.282

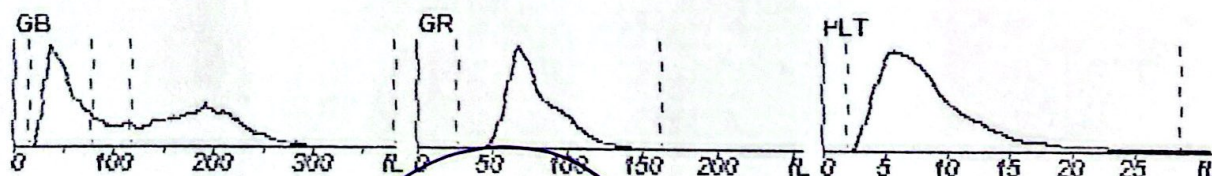

Expéd. :

Testeur :

Contrôleur :

